


# UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

## C65 & C66 Waterproof EC Pens

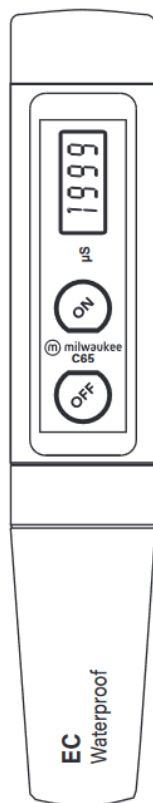

### SPECIFIKACE

<b>Rozsah</b>	C65 0 až 1999 C66 0.00 až 10.00 mS/cm
<b>Rozlišení</b>	C65 1 $\mu$ S/cm C66 0.01 mS/cm
<b>Přesnost (@25 °C)</b>	Cca 2% F.S
<b>Teplotní kompenzace</b>	Automatická, 0 až 50 °C s $\beta=2\%/^{\circ}\text{C}$
<b>Kalibrace</b>	Manuální, na bod 1 přes trimr
<b>Sonda</b>	C65 MA73075 (vyměnitelný) C66 MA73076 (vyměnitelný)
<b>Prostředí</b>	0 až 50 °C; 100% RH
<b>Typ baterie</b>	3 x 1,5V, alkalická
<b>Životnost baterie</b>	Cca 250 hodin nepřetržitého používání
<b>Rozměry</b>	165 x 30 x 30 mm
<b>Hmotnost</b>	80 g

### PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁHRADNÍ DÍLY

<b>MA73075</b>	Vyměnitelná sonda vodivosti, LR
<b>MA73076</b>	Vyměnitelná sonda vodivosti, HR
<b>M10031B</b>	1413 $\mu\text{S}/\text{cm}$ kalibrační roztok, 20 ml (25 ks)

## **CERTIFIKACE**

Přístroje Milwaukee odpovídají evropským směrnicím CE. Likvidace elektrického a elektronického zařízení. Nezacházejte s tímto výrobkem jako s domovním odpadem. Předejte jej na příslušné sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Likvidace použitých baterií. Tento výrobek obsahuje baterie. Nevyhazujte je s ostatním domovním odpadem. Předejte je na příslušné sběrné místo k recyklaci. Vezměte prosím na vědomí: správná likvidace produktu a baterie zabraňuje potenciálním negativním dopadům na lidské zdraví a životní prostředí. Pro podrobné informace kontaktujte místní službu pro likvidaci domovního odpadu nebo navštivte [www.milwaukeeinstruments.com](http://www.milwaukeeinstruments.com) (USA & CAN) nebo [www.milwaukeeinst.com](http://www.milwaukeeinst.com).

## **DOPORUČENÍ**


Před použitím tohoto produktu se ujistěte, že je zcela vhodný pro vaši konkrétní aplikaci a pro prostředí, ve kterém se používá. Jakákoli úprava provedená uživatelem na dodaném zařízení může ohrozit výkon měřiče. Pro vaši bezpečnost a bezpečnost měřiče nepoužívejte ani neskladujte měřidlo v nebezpečném prostředí. Abyste předešli poškození nebo popálení, neprovádějte žádná měření v mikrovlnných troubách.

## **ZÁRUČNÍ PODMÍNKY**

Na tyto nástroje se vztahuje záruka na vady materiálu a výroby po dobu 2 let od data nákupu. Na sondu je poskytována záruka 1 rok. Tato záruka je omezena na opravu nebo bezplatnou výměnu, pokud přístroj nelze opravit. Na poškození způsobené nehodami, nesprávným používáním, manipulací nebo nedostatkem předepsané údržby se záruka nevztahuje. Pokud je vyžadován servis, kontaktujte místní technickou službu Milwaukee Instruments. Pokud se na opravu nevztahuje záruka, budete informováni o vzniklých poplatcích. Při přepravě jakéhokoli měřiče se ujistěte, že je správně zabalen pro úplnou ochranu.


## KALIBRACE

- Ponořte přístroj do 1413  $\mu\text{S}/\text{cm}$  (M10031) kalibračního roztoku.
- Odšroubujte víčko přihrádky na baterie na horní straně měřiče.
- Nechte hodnotu stabilizovat a pomocí malého šroubováku otáčejte kalibračním trimrem (malým šroubkem v blízkosti baterií uvnitř bateriového prostoru), dokud se na displeji nezobrazí „1413“ pro C65 nebo „1,41“ pro C66.
- Nasadte víčko na přihrádku pro baterie.
- Kalibrace je nyní dokončena.

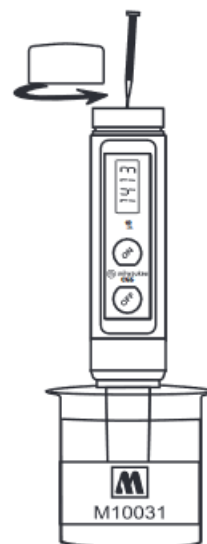

## NÁVOD K POUŽITÍ

- Odstraňte ochranný kryt.
- Zapněte měřič stisknutím tlačítka ON.
- Ponořte sondu do testovaného roztoku.
- Jemně promíchejte a počkejte, až se hodnota stabilizuje.
- Po použití opláchněte elektrodu vodou, abyste minimalizovali kontaminaci.
- Po použití vždy nasadte ochranný kryt.

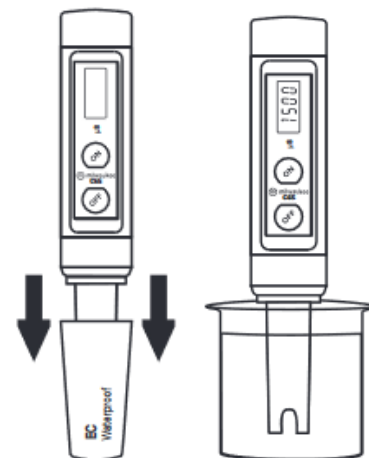


*Poznámka: pokud je naměřená hodnota nad rozsah, na displeji se zobrazí "1".*

## VÝMĚNA SONDY

Sonda lze snadno vyměnit v následujícím způsobem:

- Odstraňte ochranný kryt.
- Odšroubujte plastový kroužek na horní straně sondy.
- Vytáhněte sondu MA73075 (nebo MA73076) a nahradte ji novou (zarovnejte barevný kolík směrem ke straně LCD).
- Před zašroubováním plastového kroužku se ujistěte, že jsou těsnění na svém místě.

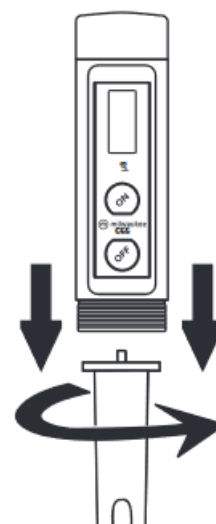

## **VÝMĚNA BATERIE**

Při výměně baterií odšroubujte víčko přihrádky na baterie a vyměňte všechny tři 1,5V baterie, přičemž dbejte na jejich polaritu. Před zašroubováním uzávěru se ujistěte, že je těsnění na svém místě. Baterie by měly být vyměňovány pouze v prostředí, které není nebezpečné. Používejte typ baterií uvedeného v tomto návodu k obsluze.

*Návod pro Vás vypracoval [juwelakvarium.cz](http://juwelakvarium.cz).  
V případě dotazů k produktu nás můžete kontaktovat.*